

# Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer<sup>®</sup>

## Manual do Usuário

CE  
2797



*Ajudando a detectar distúrbios gastrointestinais, uma respiração de cada vez.*

## Definições

**AVISO:** indica uma situação potencialmente perigosa, que, se não for evitada, pode resultar em lesão pequena ou moderada.

**CUIDADO:** indica uma situação potencialmente perigosa, que, se não for evitada, pode resultar em danos ao dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** usada para chamar a atenção para informações importantes que devem ser seguidas durante o uso.

## Informações/lembretes importantes

**OBSERVAÇÃO:** Somente dados técnicos são coletados pelo Bedfont®. Não são coletados dados dos pacientes.

**AVISO:** Leia o manual antes do uso.

**AVISO:** Nunca use álcool ou agentes de limpeza que contenham álcool ou outros solventes orgânicos, pois esses vapores danificarão internamente o sensor eletroquímico.

**AVISO:** Sob nenhuma circunstância o instrumento deve ser submerso ou respingado com líquidos.

**AVISO:** Os testes de respiração só devem ser realizados com acessórios Bedfont®. Não fazer isso pode causar leituras incorretas.

**AVISO:** Os bocais são para utilização por apenas um paciente e podem ser usados em no máximo três testes. A reutilização extra pode causar leituras incorretas e aumentar o risco de infecção cruzada. O bocal deve ser descartado após o uso, de acordo com as orientações locais de descarte de resíduos.

**AVISO:** Os pacientes devem prender a respiração durante o tempo indicado pelo dispositivo durante o teste de respiração. Não fazer isso pode causar leituras incorretas.

**AVISO:** Para obter que a amostra de respiração seja coletada na velocidade de fluxo correta, o dispositivo deve ser mantido na vertical o tempo todo durante o teste de respiração.

**AVISO:** Não bloqueie as aberturas de saída no dispositivo em nenhum momento. Bloquear as aberturas de saída pode causar leituras errôneas.

**CUIDADO:** Garanta que o dispositivo seja usado com as faixas indicadas de temperatura e umidade operacionais. A temperatura operacional é de 15 a 35°C. A umidade operacional é de 25 a 80% de RH (não condensante).

**CUIDADO:** O equipamento portátil e móvel de comunicação de RF pode afetar os dispositivos Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer®.

**OBSERVAÇÃO:** Ao selecionar um acessório para o dispositivo Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer®, tenha consciência de que um acessório não recomendado pela Bedfont® pode resultar em perda de desempenho e danos ao seu dispositivo Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer®. A garantia do produto não cobre falhas ou danos do produto resultantes do uso com acessórios não aprovados.

**OBSERVAÇÃO:** Consulte as diretrizes de controle e manutenção de infecção da Bedfont para obter mais informações sobre controle de infecção.

**OBSERVAÇÃO:** Não tente modificar o equipamento de forma alguma nem use o acessório não especificado pelo fabricante. Qualquer tentativa de fazer isso invalidará a garantia e poderá comprometer a segurança do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** A Bedfont® disponibilizará treinamento de serviço sob demanda para pessoal adequadamente qualificado.

## Conteúdo

Definições.....	1
Informações/lembretes importantes .....	1
Introdução.....	4
Layout do instrumento .....	5
Interface do usuário.....	6
Fazendo um teste de respiração.....	7
Fazendo um teste de máscara facial.....	11
Realizando testes de respiração com vários pacientes .....	13
Perfis de pacientes.....	18
Tempos predefinidos no protocolo .....	19
Editar tempos do protocolo.....	20
Editar nomes do protocolo .....	21
Limites predefinidos no protocolo.....	23
Editar limites positivos predefinidos do protocolo.....	24
Revisando o histórico.....	26
Alterando data e hora.....	27
Especificação técnica .....	28
Informação de segurança .....	29
Ambiente.....	30
Símbolos do visor .....	32
Manutenção.....	34
Calibragem .....	36
Solução de problemas.....	39
Software GastroCHART™ – conexão com o PC.....	39
Referências.....	41
Fabricante e contatos responsáveis.....	41

## Introdução

H<sub>2</sub> é gerado no lúmen intestinal por ação bacteriana em carboidratos no intestino grosso ou delgado. Depois que o H<sub>2</sub> resultante entra na corrente sanguínea, ele é transportado para os alvéolos e depois pode ser detectado no ar expiratório. Levitt<sup>1</sup> demonstrou a correlação entre a produção de H<sub>2</sub> no lúmen intestinal e a excreção de H<sub>2</sub> no ar expiratório. A medição precisa do H<sub>2</sub> em partes por milhão (ppm) no ar expiratório revela intolerância e/ou má absorção de carboidratos, ou crescimento excessivo de bactérias.

A operação do dispositivo é simples. Um sistema de amostra D-piece™ permite que a respiração expirada final seja amostrada com facilidade e de forma higiênica, usando os bocais SteriBreath™ Eco descartáveis de uso único e máscaras descartáveis.

O Gastro<sup>+</sup>™ pode ser usado para ajudar no diagnóstico dos seguintes distúrbios:

- Intolerância a carboidratos
- Má absorção de carboidratos
- Crescimento excessivo de bactérias no trato intestinal
- Investigação do tempo de trânsito intestinal

## Conformidade

O dispositivo Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer® recebe certificação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

Consulte a seção "Informações de segurança" deste manual para obter mais informações sobre a conformidade do dispositivo Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer®.


## Uso pretendido

O Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer® é um dispositivo de hidrogênio na respiração (H<sub>2</sub>) usado para medir os níveis de hidrogênio na expiração. Destina-se ao uso multipaciente por profissionais de saúde em um ambiente clínico.

## Contraindicações

Não há contraindicações conhecidas.

## Layout do instrumento

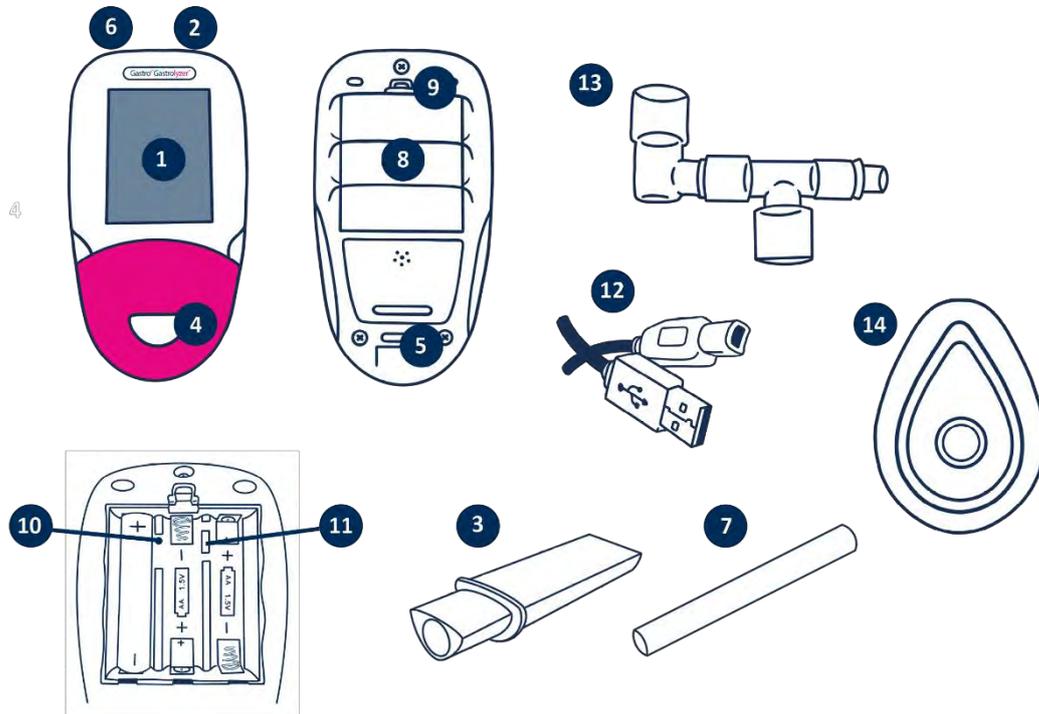

- |  |   |
|--|---|
| 1. Visor   | 8. Compartimento da bateria                   |
| 2. Botão liga/desliga                                  | 9. Clipe do compartimento da bateria          |
| 3. D-piece™ para amostra de respiração                 | 10. Botão Reset                               |
| 4. Abertura D-piece™                                   | 11. Chave de programação                      |
| 5. Abertura de saída para amostra de respiração        | 12. Cabo USB (1 m)                            |
| 6. Conector USB (para uso com o software GastroCHART™) | 13. Sistema de amostragem de máscaras faciais |
| 7. Bocal SteriBreath™ Eco de uso único                 | 14. Máscara facial                            |

## Interface do usuário




### Tela inicial

1. Status da bateria
2. Teste de respiração da máscara facial
3. Teste de respiração normal
4. Teste de ar para múltiplos pacientes
5. Perfis de pacientes
6. Configurações



A tela de informações exibe dados sobre o dispositivo e o sensor.

## Fazendo um teste de respiração



Acople um bocal D-piece™ e SteriBreath™ Eco de amostra de respiração.




Ligue o dispositivo pressionando o botão liga/desliga uma vez.

Pressione o ícone do teste de respiração na tela.



Se aparecer o cronômetro, o sensor estará estabilizando.



Inspire e prenda a respiração para a contagem regressiva predefinido de 15 segundos, conforme mostrado na tela. Se não for possível segurar a respiração por 15 segundos, o cronômetro poderá ser ajustado nas configurações.



Pressione o botão de início a qualquer momento para cancelar o teste de respiração.



Soará um bipe sonoro durante os últimos três segundos da contagem regressiva.





Sopre lentamente no bocal, com o objetivo de esvaziar os pulmões completamente.



**15**  
ppm H<sub>2</sub>



O PPM aumentará e se manterá na tela.




**15**  
ppm H<sub>2</sub>



Quando o teste for concluído, o teste de respiração, e os ícones de início e gravação aparecerão na parte inferior da tela.

Para repetir o teste de respiração, pressione o ícone do teste de respiração e repita as etapas.

Para retornar à tela inicial, pressione o ícone de início.

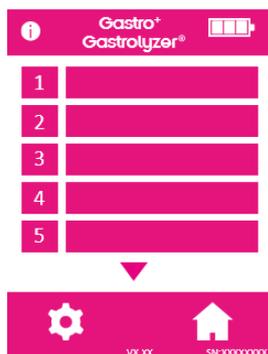

Para salvar a leitura, pressione o ícone Salvar e selecione o perfil do paciente relevante.

Remova o D-piece™ entre os testes para purgar o sensor com ar fresco.

Para desligar, pressione e segure o botão liga/desliga por três segundos; a unidade também desligará após 45 minutos de inatividade para economizar energia.

## Fazendo um teste de máscara facial



Acople um novo sistema de máscara facial.

Ligue o dispositivo pressionando o botão liga/desliga uma vez.

Pressione a opção de teste de respiração da máscara facial.




Se aparecer o cronômetro, o sensor estará estabilizando.



Inspire e expire na máscara facial; o dispositivo fará a leitura em tempo real.



Os níveis de PPM aumentarão e se manterão no nível de pico; quando parar de subir por um período de cinco segundos consecutivos, o resultado do teste poderá ser registrado e o teste vai parar.

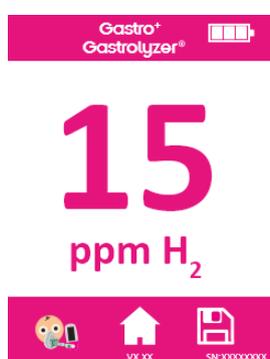

Quando o teste for concluído, o teste de respiração com a máscara facial, e os ícones de início e gravação aparecerão na parte inferior da tela.

Para repetir o teste de respiração, pressione o ícone do teste de respiração da máscara facial e repita as etapas.

Para retornar à tela inicial, pressione o ícone de início.

Remova o sistema de amostragem de máscaras faciais entre os testes para purgar o sensor com ar fresco.

Para desligar, pressione e segure o botão liga/desliga por três segundos; a unidade também desligará após 45 minutos de inatividade para economizar energia.

## Realizando testes de respiração com vários pacientes

**AVISO:** Verifique se as baterias estão cheias ou o dispositivo está conectado à porta USB do computador (ela será alimentada pelo USB). Se o dispositivo perder energia durante o modo de teste automático, apenas os resultados salvos permanecerão no dispositivo e os horários do protocolo serão perdidos.

O Gastro+™ Gastrolyzer® permite testes automáticos para até 10 pacientes em uma sessão a ser configurada, o que pode economizar muito tempo em uma clínica movimentada. Isso pode ser feito seguindo-se estas etapas:




Pressione o ícone de múltiplos pacientes na tela principal; isso irá para a tela do banco de dados do paciente, na qual é possível selecionar os pacientes que foram adicionados antes. Para adicionar pacientes, siga as instruções na seção "Adicionando perfil de paciente" deste manual.



Até 10 pacientes podem ser selecionados para teste, simplesmente pressionando no espaço de nome. Os pacientes selecionados mudarão de rosa para verde quando selecionados; para desmarcá-los, pressione no espaço do nome novamente e ele voltará para rosa.

Depois que os pacientes desejados forem selecionados, pressione a seta direita na parte inferior da tela para avançar para a tela do protocolo.

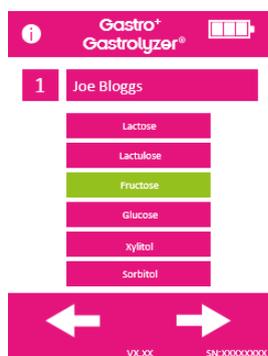

Selecione o protocolo para cada paciente; o nome deles será mostrado na parte superior da tela.

Selecione o protocolo pressionando seu nome, por exemplo, "lactose"; quando selecionado, o protocolo mudará para verde. Para editar os horários do protocolo, consulte a seção "Editar protocolos de teste" deste manual.

Pressione a seta direita na parte inferior da tela para progredir para o próximo paciente.



Quando o protocolo final for selecionado, e ao selecionar um paciente durante o teste, três opções aparecerão para o primeiro paciente. O nome deles será mostrado na parte superior da tela.

Para realizar um teste de respiração (observe que, se esta for a amostra base, não se deve dar nenhum substrato/açúcar ao paciente antes deste ponto), pressione e siga as etapas 4-8 da seção "Fazendo um teste de respiração" deste manual.

Para realizar um teste de máscara facial (observe que, se esta for a amostra base, não se deve dar nenhum substrato/açúcar ao paciente antes deste ponto), pressione e siga as etapas 3-6 da seção "Fazendo um teste de máscara" deste manual.



Se o teste não der certo por qualquer motivo, faça o teste novamente pressionando a seta para trás na tela de resultado. Isso substituirá o resultado anterior.

Para salvar essa leitura no perfil do paciente, pressione o ícone de salvar.



Esta é a amostra base; depois que o resultado for salvo, vai aparecer um prompt dizendo para dar ao paciente o substrato/açúcar relevante.

Depois que o paciente fizer isso, pressione a seta para direita para continuar com o próximo paciente. Isso também iniciará o próximo cronômetro de teste de respiração para o paciente anterior.

O dispositivo solicitará o próximo paciente, testado da mesma maneira.



Quando o paciente final fornece uma amostra e mede o substrato/açúcar, uma tela mostra todos os pacientes na sessão de teste com contagens regressivas para cada paciente até o próximo teste.

Quando o cronômetro para um paciente atingir zero, soará um alarme indicando que o próximo teste está pronto para ser feito, e o nome do paciente ficará verde.

Faça a próxima leitura para esse paciente pressionando o nome dele e seguindo as instruções acima.

Depois que cada paciente terminar o protocolo de teste, o espaço do nome ficará verde e as leituras serão salvas no perfil.



A quantidade de testes realizados e quantos são deixados para qualquer paciente pode ser visualizada selecionando-se o perfil na tela da sessão.

Se os resultados forem satisfatórios antes do término da sessão do protocolo, a sessão poderá ser encerrada mais cedo, selecionando o perfil na tela da sessão e pressionando o ícone do número de testes.



Confirme a ação pressionando o mesmo ícone na próxima tela.



Depois que a sessão completa do paciente terminar, todos os espaços de nome serão exibidos como verde.



Retorne à tela inicial para ver os resultados pressionando o ícone do perfil.

Os resultados podem ser baixados no GastroCHART™ para referência futura ou impressão. Siga as instruções na seção “Software GastroCHART™” deste manual.

## Perfis de pacientes

O Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer® permite que sejam configurados até 10 perfis de pacientes no dispositivo para gravar leituras em um perfil específico de paciente, e depois baixado posteriormente usando o GastroCHART™. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:



Pressione o ícone do perfil do paciente na tela inicial.



Pressione o perfil de um paciente para ir para a tela de edição.



Pressione o espaço do perfil do paciente novamente para inserir o nome do paciente usando o teclado fornecido.

Depois que o nome ou ID for editado, pressione o ícone de salvar.



O perfil do paciente agora foi configurado com sucesso. Mais perfis de pacientes podem ser configurados pressionando-se a seta para trás e repetindo as etapas.

Retorne à tela inicial pressionando o ícone de início.

## Tempos predefinidos no protocolo

O Gastro<sup>+</sup> Gastrolyzer<sup>®</sup> é predefinido com protocolos de teste que seguem os intervalos de tempo recomendados pela pesquisa clínica.

Teste	Dosagem	Frequência de teste (minutos)	Amostragens
Lactose <sup>3</sup>	25g of Lactose in 250ml de água	0, 15, 30, 60, 90, 120	6
Lactulose <sup>2</sup>	10g of Lactulose in 200ml de água	0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180	10
Fructose <sup>3</sup>	25g of Fructose in 250ml de água	0, 15, 30, 60, 90, 120	6
Sorbitol <sup>3</sup>	12.5g of Sorbitol in 250ml de água	0, 15, 30, 60, 90, 120	6
Xilitol <sup>3</sup>	25g of Xilitol in 250ml de água	0, 15, 30, 60, 90, 120	6
Glucose <sup>3</sup>	50g of glucose in 250ml de água	0, 15, 30, 45, 60	5

## Editar tempos do protocolo



Os tempos dos protocolos de teste podem ser editados com horas diferentes. Pressione o ícone de configurações na tela inicial.



Pressione o ícone de protocolo.



Selecione o protocolo a ser alterado; isso mudará para verde quando selecionado. Pressione a seta para direita para continuar.



Selecione até 10 intervalos de tempo pressionando o espaço de intervalo e aumentando/diminuindo as setas para cima ou para baixo.

A amostra base não pode ser alterada e será exibida como "base". Os intervalos ativos serão exibidos em verde.

Depois que o protocolo for editado, pressione o ícone de salvar. Retorne à tela de configurações.

## Editar nomes do protocolo



Os nomes dos protocolos de teste podem ser editados. Pressione o ícone de configurações na tela inicial.



Pressione o ícone de protocolo.



Selecione o protocolo a ser alterado; isso mudará para verde quando selecionado. Pressione a seta para direita para continuar.



Pressione o nome do protocolo na parte superior da tela.



Insira o nome novo ou preferido do protocolo usando o teclado fornecido.

Pressione o ícone de salvar.

## Limites predefinidos no protocolo

Abaixo está uma tabela de interpretação com orientações gerais sobre a interpretação dos valores de H<sub>2</sub> para apoiar um diagnóstico das condições. Outros fatores através do julgamento qualificado precisam ser levados em consideração, observando-se a história do paciente, os sintomas atuais e os sintomas durante o teste. As leituras de H<sub>2</sub> podem ser interpretadas como positiva ou negativa usando os seguintes limites predefinidos (este é o aumento da leitura em comparação com a amostra base):

Teste	Positive interpretation
Lactose <sup>2,3</sup>	H <sub>2</sub> ≥ 20ppm CH <sub>4</sub> ≥ 12ppm em comparação com a amostra base
Lactulose <sup>4</sup>	H <sub>2</sub> & CH <sub>4</sub> > 20ppm em comparação com a amostra base dentro de 90 minutos de ingestão de lactulose
Lactulose <sup>2</sup> SIBO*	a) Aumento precoce de pelo menos 20 ppm para a soma dos dois gases b) Increase > 20ppm correspondendo ao aparecimento de lactulose no cólon
Lactulose <sup>2</sup> IITT**	O pico rápido de ≥ 20ppm é detectado em 60 minutos O pico normal de ≥ 20ppm é detectado em 80 minutos O pico lento de ≥ 20ppm é detectado em 100 minutos ou mais
Fructose <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> ≥ 20ppm CH <sub>4</sub> ≥ 12ppm em comparação com a amostra base
Sorbitol <sup>3</sup>	H <sub>2</sub> ≥ 20ppm em comparação com a amostra base
Xilitol	H <sub>2</sub> ≥ 20ppm em comparação com a amostra base
Glucose <sup>3</sup>	H <sub>2</sub> ≥ 10ppm CH <sub>4</sub> ≥ 10ppm em comparação com a amostra base

\*SIBO = Pequeno Crescimento Excessivo de Bactérias no Trato Intestinal

\*\*IITT = Tempo de Trânsito Intestinal Prejudicado

## Editar limites positivos predefinidos do protocolo



Os nomes dos protocolos de teste podem ser editados. Pressione o ícone de configurações na tela inicial.



Pressione o ícone de protocolo.



Selecione o protocolo a ser alterado; isso mudará para verde quando selecionado. Pressione a seta para direita para continuar.



Pressione o gráfico e o ícone de PPM.



Pressione a seta para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o limite.

Pressione o ícone de salvar.

## Revisando o histórico



O Gastro<sup>+</sup> Gastrolyzer<sup>®</sup> registrará todas as leituras realizadas no histórico até 150 leituras. Para acessar isso, pressione o ícone de configurações.



Pressione o ícone de histórico.


## Alterando data e hora



Para alterar a data e a hora no Gastro<sup>+</sup> Gastrolyzer®, pressione o ícone de configurações.



Pressione o ícone de data e hora.

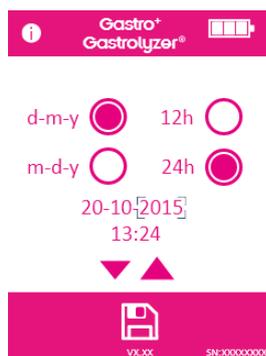

Selecione d-m-a ou m-d-a para o formato da data e 12h ou 24h para o formato da hora.

As datas e horas são ajustadas selecionando-se o número e pressionando-se as setas para cima ou para baixo para aumentar e diminuir.

Salve as configurações pressionando o ícone de salvar.

## Especificação técnica

<b>Intervalo de concentração</b>	0-500ppm
<b>Visor</b>	Tela sensível ao toque em cores
<b>Princípio de detecção</b>	Sensor eletroquímico
<b>Repetibilidade</b>	<5%
<b>Precisão</b>	≤±3ppm/10% - o que for maior*
<b>Alimentação</b>	3 x AA (LR6 ou equivalente) – até 1000 minutos 1 pilha moeda CR2032 de lítio
<b>Tempo de resposta T<sub>90</sub></b>	<40 segundos
<b>Temperatura de operação</b>	15-35°C
<b>Temperatura de armazenamento/transporte</b>	0-50°C
<b>Pressão de operação/transporte/ armazenamento</b>	±10% a pressão atmosférica
<b>Umidade operacional</b>	15-90% não condensante
<b>Umidade de armazenamento/transporte</b>	0-95%
<b>Vida útil esperada do sensor</b>	2 anos
<b>Sensibilidade do sensor</b>	1ppm
<b>Desvio do sensor</b>	<2% por mês
<b>Dimensões</b>	Aprox. 37 x 77 x 140 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 215g (incluindo as pilhas)
<b>Materiais</b>	Gabinete: mistura de policarbonato/ABS Aditivo antimicrobiano integrado D-piece™: polipropileno SteriBreath™ Eco: papel Bocal OneBreath™: polipropileno
<b>Interferência cruzada de CO</b>	<4%

\* As leituras de > 200 ppm com temperatura entre 26-35 °C podem diminuir a precisão para 15%.

## Informação de segurança

Grau de proteção contra choque elétrico	Peça aplicada do tipo BF
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento com potência interna
Grau de proteção contra a entrada de líquido	IPXO - não protegido contra a entrada de água
Grau de aplicação de segurança na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nítrico	Equipamento não adequado para uso na presença de misturas inflamáveis.
Corrente contínua	
Marca CE	
EC-REP	
Peça aplicada do tipo BF	
Descarte de acordo com WEEE	
Número de série	
Consultar instruções de uso	
Identificação exclusiva do dispositivo	
Fabricado por	
Data de fabricação	
Indicador de dispositivo médico	
Logotipo Bedfont®	

## Ambiente

O produto Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer<sup>®</sup> está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC, conforme alterado em 2007/47/CE e o padrão de Compatibilidade Eletromagnética do Dispositivo Médico EN 60601-1-2.

**AVISO:** O equipamento portátil de comunicação de RF (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) deve ser usado a não mais de 30 cm de qualquer parte do Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer<sup>®</sup>, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá resultar em degradação do desempenho deste equipamento. Este equipamento deve ser transferido, se necessário, para evitar interferências.

<b>Orientação e declaração do fabricante: Imunidade eletromagnética (IEC 60601-1-2)</b>			
<b>O Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer<sup>®</sup> destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer<sup>®</sup> deve garantir que ele seja usado em um ambiente desse tipo.</b>			
<b>Teste</b>	<b>Nível de teste IEC 60601</b>	<b>Nível de conformidade</b>	<b>Ambiente eletromagnético – orientação</b>
Emissões irradiadas: FCC parte 15 Subparte B Classe A e EN55011:2016 + A1:2017 Classe A	30MHz a 1GHz	Atendida ou excedida	O equipamento portátil e móvel de comunicação de RF não deve ser usado mais perto de nenhuma parte do Gastro <sup>+</sup> ™ Gastrolyzer <sup>®</sup> , incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada calculada a partir da equação apropriada à frequência do transmissor.
Emissões conduzidas: FCC parte 15 Subparte B Classe A e EN55011:2016 + A1:2017 Classe A	150KHz a 30 MHz	Atendida ou excedida	
Imunidade irradiada: IEC 61000-4-3:2006 + A1 2007 + A2:2010 e EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010	3V/m (1kHz 80%) 80 MHz – 2,7 GHz Frequências à vista: 385MHz 27 V/m PM 18 Hz 450MHz 28 V/m FM 1 kHz seno 710MHz 9 V/m PM 217 Hz 745MHz 9 V/m PM 217 Hz 780MHz 9 V/m PM 217 Hz 810MHz 28 V/m PM 18 Hz 870MHz 28 V/m PM 18 Hz 930MHz 28 V/m PM 18 Hz 1720MHz 28 V/m PM 217 Hz 1845MHz 28 V/m PM 217 Hz 1970MHz 28 V/m PM 217 Hz 2450MHz 28 V/m PM 217 Hz 5240MHz 9 V/m PM 217 Hz	Atendida ou excedida	A interferência pode ocorrer nas proximidades de equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 

	5500MHz 9 V/m PM 217 Hz 5785MHz 9 V/m PM 217 Hz		
Imunidade conduzida: IEC 61000-4-6:2015 e EN61000-4-6:2014	6V rms ISM and amateur radio bands	Atendida ou excedida	
Quedas e interrupções de tensão: IEC 61000-4-11:2005 e EN61000-4-11:2004	240VAC 500ms (50/60Hz) 70% @ 0° 240VAC 20ms (50/60Hz) 100% @ 0° 240VAC 10ms (50/60Hz) 100% 240VAC 5S (50/60Hz) 100% 100VAC 500ms (50/60Hz) 70% @ 0° 100VAC 20ms (50/60Hz) 100% @ 0° 100VAC 10ms (50/60Hz) 100% @ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 100VAC 5S (50/60Hz) 100%	Atendida ou excedida	
Campo magnético de frequência de potência: IEC 61000-4-8:2012 e EN61000-4-8:2010	30 A/m (50Hz e 60Hz)	Atendida ou excedida	
Explosão transitória rápida: IEC 61000-4-4:2016 e EN61000-4-4:2012	± 2kV	Atendida ou excedida	
Surto: IEC 61000-4-5:2008 e EN61000-4-5:2006	± 0.5, 1.0 kV L-L ± 0.5, 1.0, 2.0 kV L-E 20s	Atendida ou excedida	
ESD: IEC 61000-4-2:2012 & EN61000-4-2:2009	+/- 8kV contact +/- 2, 4, 8,15kV air	Atendida ou excedida	

## Símbolos do visor

Descrição	Gastro <sup>+</sup> ™ Gastrolyzer®
Condição da bateria: cheia	
Condição da bateria: baixa	
Condição da bateria: vazia	
Teste de respiração	
Teste da máscara facial	
Teste automático de respiração do paciente	
Inspirar	
Condição da bateria: cheia	
Segurar respiração	
Editar cronômetro de contagem regressiva (segurar respiração)	
Contagem regressiva (segurar respiração)	
Expirar	
Leitura de PPM	
Salvar	
Configurações	
Início	
Perfis de pacientes	
Espaço do perfil do paciente	

Excluir registro do paciente	
Tempo até próxima amostra de respiração	 00:00  16:09  20:00
Concluir e salvar	 0/6
Alterar D-piece™	
Próxima etapa	
Etapa anterior	
Troca do sensor em breve	 15/03/20
Troca do sensor vencida	 15/03/20
Data de validade da calibragem	 12/03/2015
Calibrar dispositivo	
Acoplar medidor de fluxo ao recipiente de gás	
Acoplar adaptador de calibração ao D-piece™	
Acoplar D-piece™ ao dispositivo e ligar fluxo de gás	
Processamento do sistema	
Calibragem bem-sucedida	
Falha na calibragem	
Repetir calibragem	

Lembrete de calibragem de 3 meses	
Histórico de leitura do dispositivo	
Editar data/hora	
Versão do firmware	<b>V2.23</b>
Número de série	<b>SN: HG000001</b>

## Manutenção

### Manutenção de rotina

- Os bocais são para utilização por apenas um paciente e podem ser usados em no máximo três testes
- Leve regularmente as mãos de acordo com a prática de controle de infecção.
- Não tente modificar o equipamento de forma alguma nem use o acessório não especificado pelo fabricante. Qualquer tentativa de fazer isso invalidará a garantia e poderá comprometer a segurança do dispositivo.
- A Bedfont® disponibilizará treinamento de serviço sob demanda para pessoas adequadamente qualificadas.
- Segurar o botão de redefinição por 30 segundos executará a redefinição completa do dispositivo. Isso limpará todos os dados salvos e reverterá todas as configurações para os padrões de fábrica. Depois de executar uma redefinição, o dispositivo precisará definir a data/hora e ser calibrado antes do uso.
- Substitua as pilhas quando indicado pelo símbolo de gastas
- A Bedfont® recomenda a remoção das pilhas quando o dispositivo não é usado por períodos prolongados para evitar vazamentos.
- Substitua a amostra de respiração D-piece™ a cada 30 dias ou se estiver visivelmente suja ou contaminada. Os produtos Gastro+™ Gastrolyzer® fornecerão um lembrete durante a inicialização quando o D-piece™ for substituído. Consulte o símbolo “Alterar D-piece™”.
- O sensor deve ser substituído a cada dois anos, 60 dias antes da troca do sensor. Vai aparecer o símbolo de “contagem regressiva para troca do sensor”, com a data em que o sensor deve ser alterado. Isso pode ser ignorado pressionando-se o ícone de início até a data em que o sensor deve ser trocado. Neste momento, será mostrado o símbolo de “troca do sensor”. Troque o sensor se você for treinado por um engenheiro aprovado da Bedfont® ou envie para a Bedfont® ou para o representante local.

## Limpeza

1. O Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer® é integrado à tecnologia antimicrobiana para controle ideal de infecção e tem eficácia comprovada de proteção bacteriana. A Bedfont® recomenda limpar o instrumento e as superfícies externas da D-piece™ entre cada teste de paciente com um toalhete sem álcool que foi especificamente projetado para este fim. Uma lista de toalhetes aprovados pode ser encontrada aqui: <https://www.bedfont.com/cleaning-bedfont-devices>. O D-piece™ não pode ser esterilizado.
2. NUNCA use álcool ou agentes de limpeza que contenham álcool ou outros solventes orgânicos, pois a exposição a longo prazo a esses vapores danificará internamente o sensor de H<sub>2</sub>.
3. Sob nenhuma circunstância o instrumento deve ser submergido em líquidos ou respingado com líquidos.

## Calibragem

O Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer<sup>®</sup> é calibrado a 21°C (± 4°C) antes de sair da Bedfont<sup>®</sup>. O instrument deve ser calibrado a 21°C (± 4°C), pois essa é a temperatura na qual recomendamos que seja usado.

O Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer<sup>®</sup> deve ser calibrado a cada três meses e enviará um lembrete durante a inicialização, quando a calibragem estiver vencida. O gás de calibração necessário é 100 ppm de hidrogênio no ar.



Ligue o dispositivo pressionando o botão liga/desliga uma vez.

Pressione o ícone de configurações.



Pressione o ícone do cilindro uma vez para prosseguir.



O dispositivo deve ser zerado; isso acontecerá automaticamente.

**Não conecte o gás nesta fase.**



Verifique se a válvula de controle fina está na posição desligada.



Aparafuse a válvula de controle fina e o conjunto do indicador de fluxo para a recipiente de gás. É possível fazer isso melhor aparafusando o recipiente de gás na válvula.

Depois que isso for realizado com sucesso, a primeira etapa do processo de calibração será mostrada na tela.



Deixe o gás fluir a 0,5 litros por minuto.



Deixe o gás fluir pelo instrumento durante a duração do teste, monitorando novamente o fluxo.



Será indicada uma calibração bem-sucedida pelo ícone de “tique”. Pressione o ícone de início para retornar à tela inicial.




A falha na calibração será indicada pelo ícone de cruz vermelha. Pressione o ícone de seta rotativa para tentar a calibragem novamente. Se o problema persistir, consulte a seção de solução de problemas ou ligue para o fornecedor local dos produtos Bedfont®.



Retorne à tela inicial pressionando o ícone de início.

## Solução de problemas

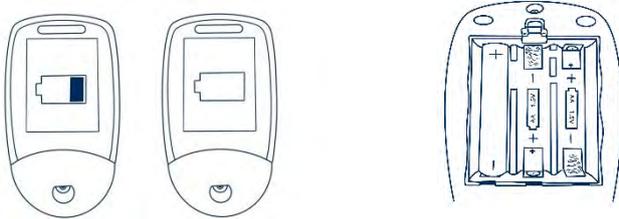


### *A unidade não liga*

Se a unidade não conseguir ligar corretamente, verifique se os símbolos de pilha baixa ou vazia são mostrados, ou substitua as pilhas. Certifique-se de que as pilhas sejam inseridas da maneira correta, combinando os símbolos moldados no plástico.

## Software GastroCHART™ – conexão com o PC



Coloque uma extremidade do cabo de conexão na entrada USB na parte superior do produto Gastro<sup>+</sup> Gastrolyzer®.

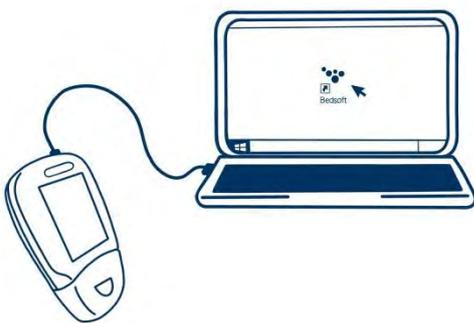

Conecte a outra extremidade à porta USB no PC.

Antes de iniciar o software, verifique se o Gastro<sup>+</sup> Gastrolyzer® está conectado ao PC e ligado. Clique duas vezes no ícone GastroCHART™ no PC para iniciar o programa. Consulte a documentação fornecida sobre como operar o GastroCHART™. O GastroCHART™ está disponível para download GRATUITAMENTE no site <https://www.gastrolyzer.com>.

## Procedimento de devolução

Se o Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer® exigir manutenção, entre em contato com o departamento, distribuidor ou fornecedor local de atendimento ao cliente da Bedfont® antes de devolver quaisquer mercadorias.

1. O departamento de consertos do cliente precisará ser fornecido com o número de série do dispositivo e a descrição da falha. Depois que essas informações forem recebidas, será emitido um número de devolução/ticket. Indique o número de devolução/ticket na parte externa da caixa ao devolver o dispositivo, e verifique se um número de telefone, número de fax e endereço de devolução completo estão claramente indicados
2. O produto também deve ser descontaminado antes de ser devolvido, de acordo com as normas locais. A Bedfont® pode fornecer um certificado de descontaminação a ser preenchido, que também precisa ser anexado à parte externa da caixa. Sem esse procedimento, o produto poderá estar sujeito ao procedimento de descontaminação da Bedfont® e atrasará o serviço/conserto e poderá incorrer em custos.
3. A Bedfont® aconselha que seja usado um serviço dos correios ao devolver dispositivos. Isso permite que as mercadorias sejam seguradas contra perda ou dano em trânsito. Quando as mercadorias são recebidas, será enviado um e-mail informando.
4. Se o dispositivo for devolvido para conserto, ele será examinado; serão enviados um “relatório de engenharia” e uma cotação para o conserto, o que também incluirá um formulário de autorização. Preencha o formulário de autorização e verifique se há incluído um “número oficial do pedido de compra”. Entre em contato com o departamento de consertos do cliente se não for possível fornecer um "número oficial do pedido de compra".
5. Se o dispositivo ainda estiver na garantia e o defeito for coberto pela garantia, consulte a seção "Garantia" deste manual. A Bedfont® o consertará e o devolverá com um "relatório de engenharia", gratuitamente.
6. Se o conserto não for realizado, será cobrada uma taxa de manuseio. Certifique-se de que seja devolvido um formulário de autorização preenchido com um “número oficial do pedido de compra”.
7. O equipamento será devolvido assim que a Bedfont® receber toda a documentação relevante. Será cobrada uma taxa de transporte se o dispositivo não estiver mais na garantia.

## Garantia

A Bedfont® Scientific Limited garante que o produto Gastro<sup>+</sup>™ Gastrolyzer® e o sensor de H<sub>2</sub> (excluindo as baterias) estejam livres de defeitos em materiais e mão de obra por um período de dois anos a partir da data de remessa. A única obrigação da Bedfont® sob esta garantia é limitada ao reparo ou substituição - à sua própria escolha - de qualquer item coberto por esta garantia no caso de tal item ser devolvido, intacto e pré-pago, à Bedfont® ou ao representante local.

Essas garantias são automaticamente anuladas se os produtos forem consertados ou alterados, se os adesivos de lacre foram removidos ou de outra forma adulterados por pessoal não autorizado, ou se os produtos estiverem sujeitos a uso indevido, negligência ou acidente.



Nunca descarte nenhum instrumento eletrônico ou baterias e pilhas em resíduos domésticos. No final da vida do produto, entre em contato com a Bedfont® ou seu distribuidor para obter instruções de descarte.

## Referências

1. Levitt, M.D. (1969): Production and excretion of hydrogen gas in man. New Engl. J.Med. 281:122-127
2. Biolab Medical Unit; Nutritional and Environmental Medicine; London England. Breath Hydrogen and Methane February 2012. Available at <http://www.biolab.co.uk/docs/bhydro.pdf>
3. Ledochowski M. Ledochowski E. Hydrogen Breath Tests 2008; Available from Bedfont® Scientific Ltd
4. Pimental M. et al Methane Production during Lactulose Breath Test is Associated with Gastrointestinal Disease Presentation. Digestive Diseases and Sciences. Vol. 48 No. 1 2003
5. Health Protection Agency (HPA). Porton Down, Report No. 43/06. Pp. 10-11
6. Public Health England (PHE). Report No. 17/001.
7. Public Health England (PHE). Report No. 20/045C.

## Fabricante e contatos responsáveis

Bedfont® Scientific Ltd.  
Station Yard, Station Road,  
Harrietsham,  
Maidstone, Kent,  
ME17 1JA  
Reino Unido

[www.gastrolyzer.com](http://www.gastrolyzer.com)  
[ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com)  
0044 1622 851122



***Nossa família, inovando saúde, para a sua.***

Visita [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) para ver este documento em outros idiomas.



**Bedfont® Scientific Ltd.**  
Station Road, Harrietsham, Maidstone,  
Kent, ME17 1JA England  
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Web: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)



Distribuido por: Dorja Ind. e.  
Com.  
de Equip. Médicos Ltda  
CNPJ. 50.208.271/001-05  
Nº ANVISA:  
[www.dorja.com.br/](http://www.dorja.com.br/)  
e-mail: [sac@dorja.com.br](mailto:sac@dorja.com.br)



**Stephen Rowe**  
Cristimar E4-1  
Ave Juan Carlos I  
Los Cristianos, Arona, 38650  
Santa Cruz de Tenerife, Spain

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Edição 13 - Janeiro 2024, Part No: LAB678\_PTBR  
A Bedfont® Scientific Limited reserva-se o direito de alterar ou atualizar sua literatura sem aviso prévio.  
Registrado em: Inglaterra e País de Gales. Nº registrado: 1289798



MD 502905